
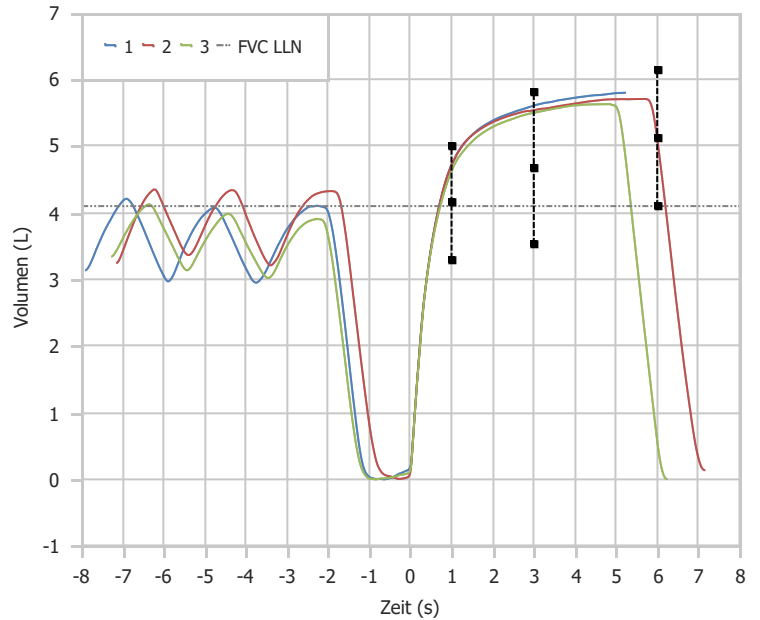


Geschlecht bei Geburt	Männlich	BMI	-	Sitzungsstufen	FVC A; FEV1 A
Alter	36,90	Normwertsatz	GLI_CAUC	Gerätename	Vitalograph Micro
Geburtsdatum	11.11.1985	Korrekturfaktor	1	Seriennummer	MV15164
Population	-	Umgebungstemperatur	23 C	Genauigkeit	07.09.2022
Gewicht	-	Körperh.	Sitzend		
Größe	175 cm	Anzahl der Tests	3		

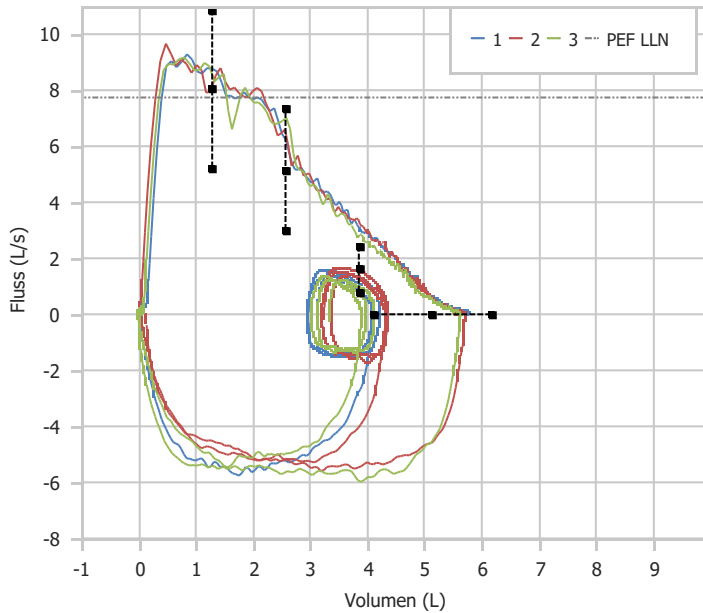

Parameter	Bestw.	Norm	LLN	% Sollwert	Bestw. 1 10:44:58	Bestw. 2 10:44:07	Bestw. 3 10:44:30
VC (L)	5,47	5,13	4,10	107	5,47	5,47	5,47
FVC (L)	5,71	5,13	4,10	111	5,80	5,71	5,63
FEV1 (L)	4,73	4,17	3,31	113	4,73	4,72	4,62
FEV1 Verhältnis	0,82	0,82	0,71	100	0,82	0,83	0,82
PEF (L/min)	580	599	464	97	557	580	550
FEF25-75 (L/s)	4,53	4,15	2,47	109	4,53	4,67	4,51

Werte bei BTPS

Testsitungsqualität und Reproduzierbarkeit			
FVC-Repr.:	FEV1-Repr.:	FVC-Stufe	FEV1-Stufe
0,09L (2,00%)	0,01L (0,00%)	A	A
Atemstöße	3		

Interpretationen	
Interpretationen	Computer-Interpretationen dürfen nicht zur Diagnose verwendet werden. Normal.
Geschätztes Lungenalter	37

Sitzungsnotizen
-

Probanden-Bemerkungen
-